

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2023

Số: 26./TMBG-BVTTB

V/v đề nghị cung cấp báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Cơ sở 2 đang có nhu cầu mua sắm thiết bị xét nghiệm với nội dung chi tiết hàng hóa:

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy ủ nhiệt 37 độ	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa mới 100%- Bảo hành ≥ 12 tháng- Năm sản xuất từ năm 2022 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn ISO/EC/ FDA- Nhiệt độ cài đặt: Nhiệt độ môi trường đến $99,9^{\circ}\text{C}$- Màn hình số hiển thị thông số nhiệt độ và thời gian- Số lượng ống nghiệm:<ul style="list-style-type: none">+ 20 ống x đường kính 10,5mm+ 20 ống x đường kính 13,5mm+ 12 ống x đường kính 16,6mm- Độ sai số nhiệt độ: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$- Độ đồng đều nhiệt độ (ở 37°C): $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$- Loại Sensor cảm biết nhiệt độ: PT-100- Kiểu điều khiển nhiệt độ: PID- Thời gian cài đặt hoạt động: tối đa 99 giờ 59 phút- Được thiết kế với cảnh báo nhiệt độ vượt quá- Nguồn điện hoạt động: 220V/ 50Hz- Công suất tiêu thụ: 450W- Kích thước máy: 370 x 245 x 145mm	Cái	01
2	Máy lắc tròn	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa mới 100%- Bảo hành ≥ 12 tháng- Năm sản xuất từ năm 2022 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn ISO/EC/ FDA- Kiểu chuyển động: tròn	Cái	01

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính lắc: 10 mm - Trọng lượng lắc tối đa: 7.5 kg - Công suất vào/ra của mô tơ: 45/10 W - Khoảng tốc độ lắc: 0-500 vòng/phút. - Hiện thị tốc độ/ thời gian: LED line - Khoảng cài đặt thời gian: 5-50 phút - Kiểu vận hành: theo thời gian và liên tục - Kích thước máy (rộng x sâu x cao): 360 x 420 x 98 mm - Trọng lượng máy: 8.5 kg - Lớp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN, EN 60529: IP 21 - Điều kiện môi trường làm việc: - Nhiệt độ: 5-50°C - Độ ẩm: 80% - Nguồn điện sử dụng: 220-240/100-120 V, 50/60 Hz - Công suất: 45 W 		
3	Máy ly tâm 04 ống	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa mới 100% - Bảo hành \geq12 tháng - Năm sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO/EC/ FDA - Dung tích ly tâm tối đa: 12 ống x 5 ml - Tốc độ cài đặt tối đa: 14.000 vòng / phút - Bước cài đặt tốc độ: 100 vòng / phút - Lực ly tâm đạt tới 15.558 xg RCF - Cài đặt thời gian tối đa : 99 phút - Bước cài đặt thời gian : 1 phút - Động cơ không sử dụng chổi than - Kích thước nhỏ gọn: 199 x 231 x 292 mm - Khối lượng: nặng 6 kg - Nguồn điện : 208 – 240V/ 50 – 60Hz., 185 VA 	Cái	01

Ban Vật tư Thiết bị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 2 kính mời Quý Đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên gửi báo giá về Ban Vật tư Thiết bị - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM) trong thời gian sớm nhất (kèm mẫu báo giá tham khảo).

Lưu ý:


- Giá chào đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban VTTB (J08-005-2-nththu).

TRƯỞNG BAN VẬT TƯ THIẾT BỊ

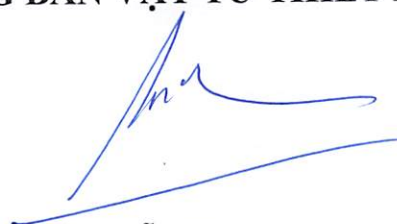

Đặng Nguyễn Ngọc An